



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0599

检测报告

编号

日期

第 1 页 共 3 页

Test Report

No. SL520252461815TX

Date: 2020-5-18

Page 1 of 3

下列样品由客户提供及确认为:

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

客户信息 Client Information	委托单位: Consignor:	上海锦泽诚工业防护用品有限公司 JINZECHENG (SHANGHAI) INDUSTRIAL PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD.		
	委托单位地址: Consignor address:	上海市松江区洞泾镇振业路 133 号		
样品信息 Sample Information	样品描述: Sample Description:	防护服: 颜色为白色。 Protective clothing: in white.		
	款号: Style No.	GL-002		
	款名: Style Name.	一次性隔离衣		
	品牌名称: Brand Name:	锦禾		
	样品数量: Sample Quantity:	1 件 One piece		
检测信息 Test Information	检测类别: Test Type:	委托送样检测 Submitted (sample sent by client)		
	样品送达日期: Sample Received Date:	2020-04-29	检测周期: Test Period:	2020-04-29~2020-05-18
	检测依据: Document Accordance:	详见检测结果页 Detail please see follow page		
	判定依据: Judging Accordance:	客户要求: GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 Client's requirement: GB 19082-2009 Technical requirements for single-use protective clothing for medical use		
检测结论: Test Conclusion	本报告仅提供实测数据和单项判定, 详见检测结果页。 The report only give the test result and individual judgment, details please see follow page.			

通标标准技术服务(上海)有限公司

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co. Ltd

批准人签署 Approved by:

崔小英 Ellen Cui

(授权签字人 Authorized Signatory)

测试结果仅对来样负责

This test report refer only to the samples tested



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性负责, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



检测报告

编号

日期

第 2 页 共 3 页

Test Report

No. SL520252461815TX

Date: 2020-5-18

Page 2 of 3

检测结果及评判 Test Results and Judgement

GB 19082-2009 检测项目 Test items:

序号 No.	检测项目及测试方法 Test Items & Test Methods	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results		单项判定 Individual Judgment
1.	抗渗水性 Resistance to Water Penetration (GB 19082-2009 5.4.1)	kPa	静水压 Hydrostatic Pressure ≥1.67	5.00		符合 Pass
2.	透湿量 Water Vapour Transmission (GB 19082-2009 5.4.2)	g/(m ² .d)	≥2500	9180		符合 Pass
3.	表面抗湿性 Resistance to Surface Wetting (GB 19082-2009 5.4.4)	级 Grade	≥3	试样 1 Specimen 1	4	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	4	
				试样 3 Specimen 3	4	
4.	断裂强力 Tensile Strength (GB 19082-2009 5.5)	N	≥45	长度方向 lengthwise	100	符合 Pass
				宽度方向 widthwise	58	
5.	断裂伸长率 Tensile Elongation (GB 19082-2009 5.6)	%	≥15	长度方向 lengthwise	126	符合 Pass
				宽度方向 widthwise	113	
6.	抗合成血液穿透性 Resistance to Penetration by Synthetic Blood (GB 19082-2009 5.4.3)	级 Grade	≥2	3		符合 Pass




除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

序号 No.	检测项目及测试方法 Test Items & Test Methods	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项判定 Individual Judgment
7.	结构 Structure (GB 19082-2009 5.2)	-	防护服有连帽上衣、裤子组成, 可分为连身式结构和分身式结构。 Protective clothing consists of a hooded jacket and pants, which can be divided into one-piece structure and split structure.	符合要求 Meet Requirement	符合 Pass
		-	防护服的结构应合理, 穿脱方便, 结合部位严密。 The structure of protective clothing should be reasonable, easy to put on and take off, and The joints should be tight.	符合要求 Meet Requirement	
		-	袖口、脚踝口采用弹性收口, 帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 Cuffs and ankles should be elastically closed, the neckline of the hat and the waist should be elasticized, drawstring or buckled.	符合要求 Meet Requirement	

备注: 此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值, 未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。

Remark: The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

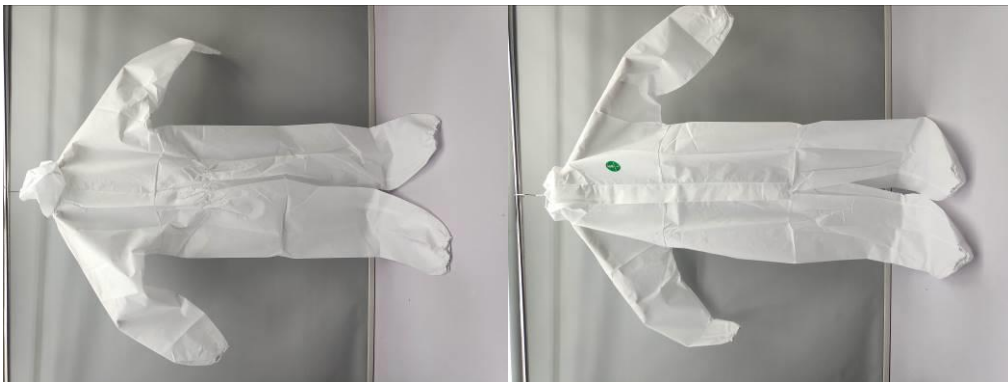

报告结束

End of report



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com